

106 年度民營上字第 3 號附圖

附圖一：

圖 2、3 係保健氫氧氣供應設備之較佳實施例



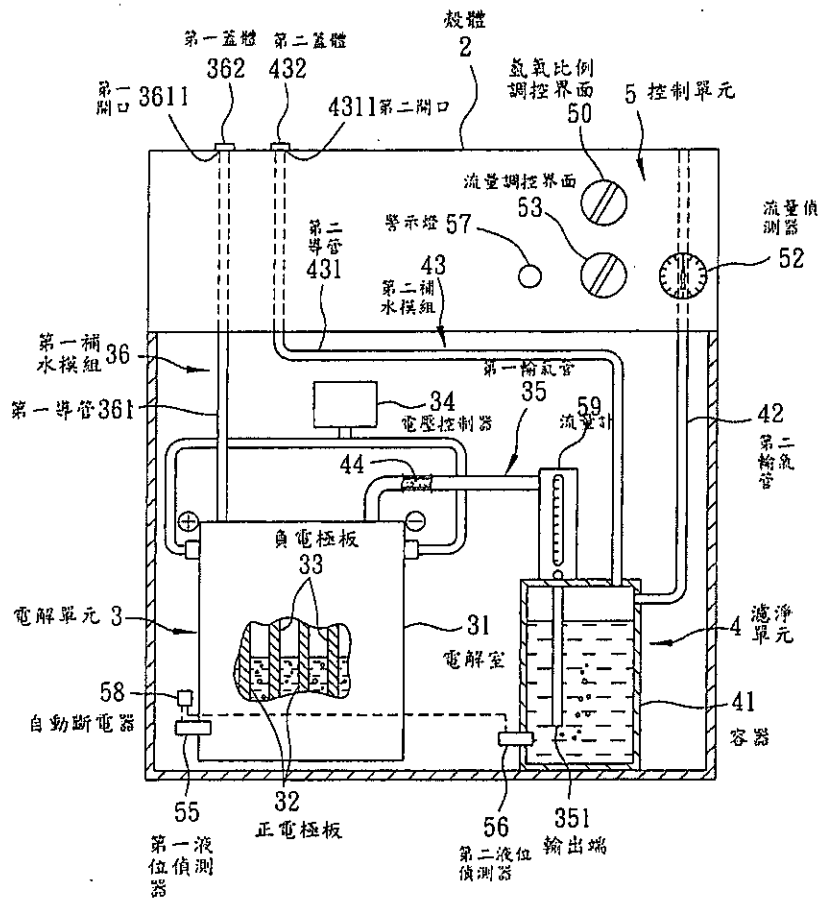


圖 2

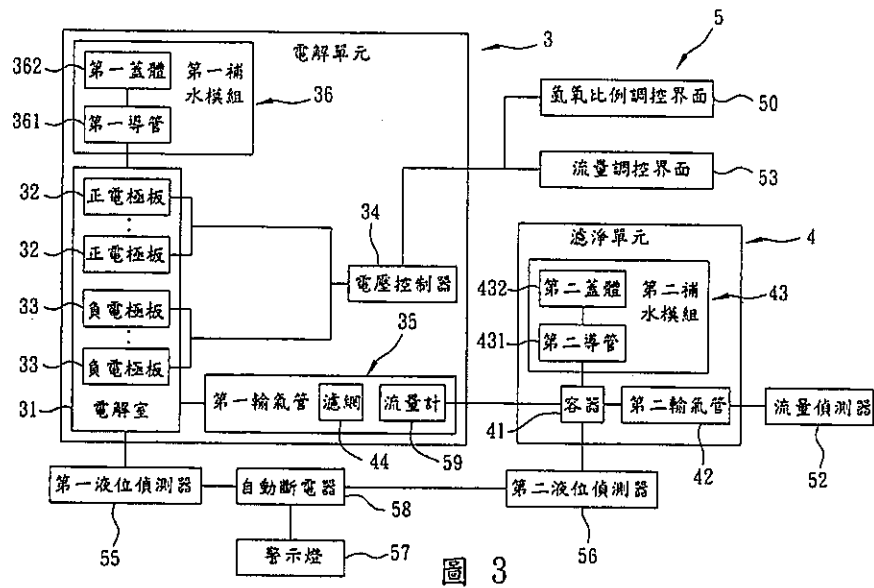


附圖二：

CN203291354U、CN203291353U 之圖 1

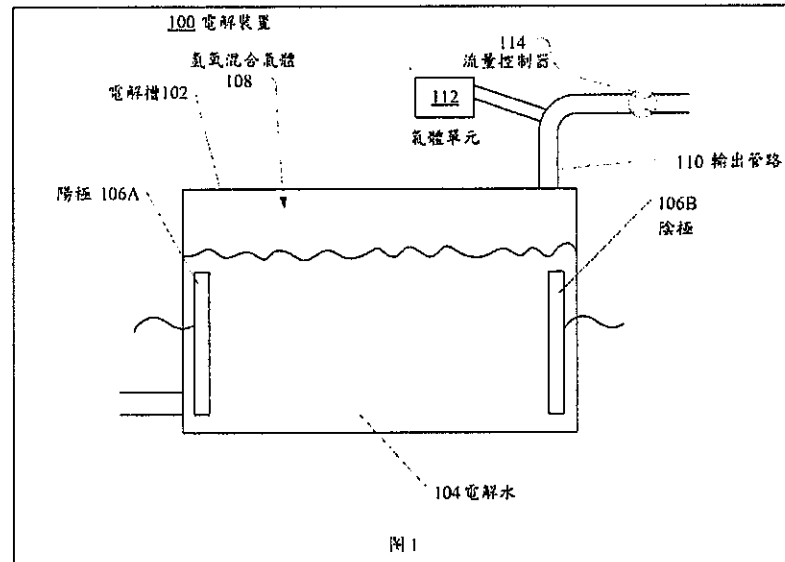


CN203291354U、CN203291353U 之圖 2

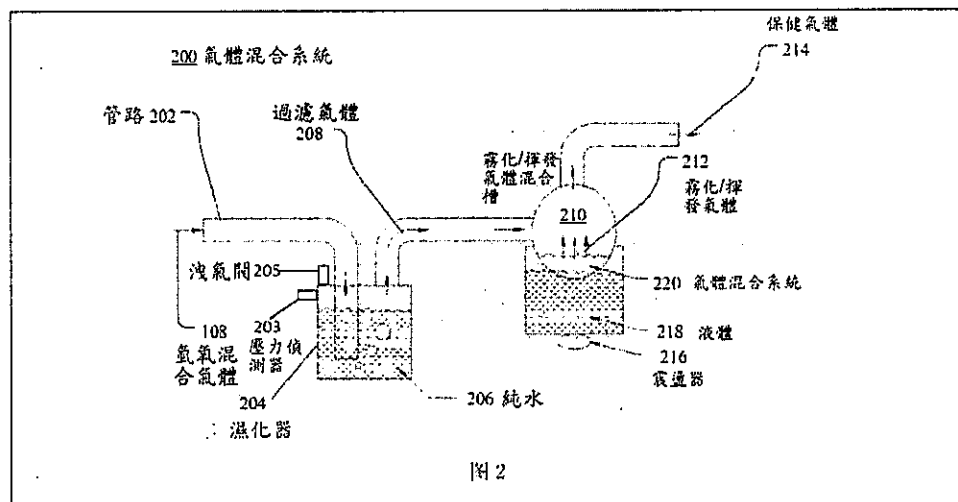


附圖三：

CN203295619U 之圖 2

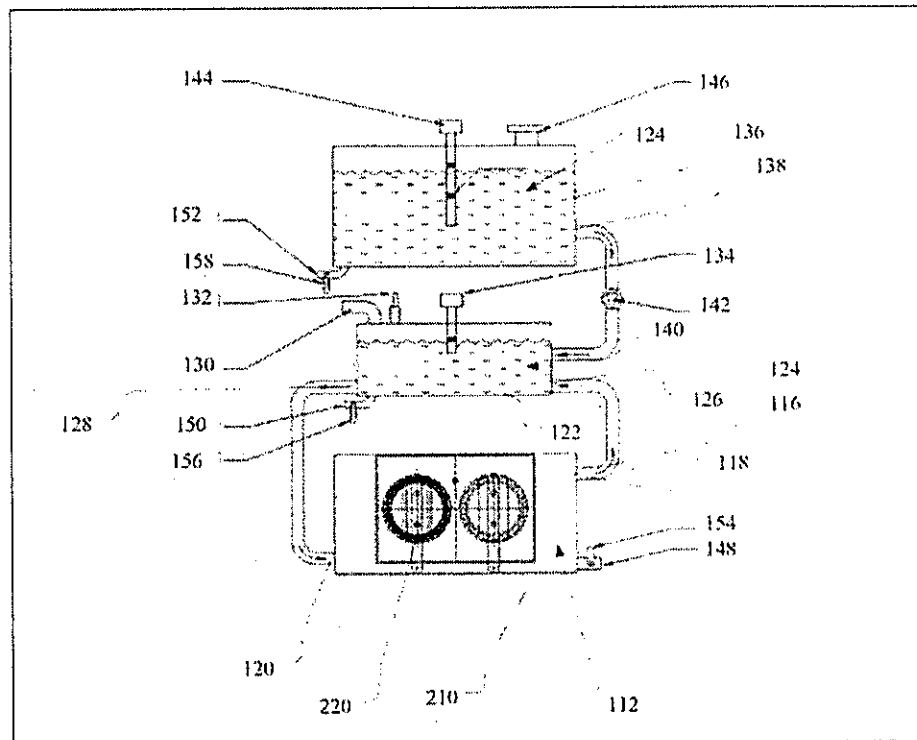


- | | | |
|-------------|-------------|------------|
| 112：電解水 | 116：氫氧氣 | 118：第一氣體出口 |
| 120：第一入水口 | 122：第一儲水桶 | 124：純水 |
| 126：氣體入口 | 128：第一出水口 | 130：第二氣體出口 |
| 132：洩壓裝置 | 134：第一水位偵測器 | 136：第二儲水桶 |
| 138：第二出水口 | 140：第二入水口 | 142：液體閥 |
| 144：第二水位偵測器 | 146：第二注水口 | 148：第一排水口 |
| 150：第二排水口 | 152：第三排水口 | 154：第一排水閥 |
| 156：第二排水閥 | 158：第三排水閥 | 200：氣水循環系統 |
| 210：電解槽 | 220：雙峰筒 | |


CN203295619U 之圖 3

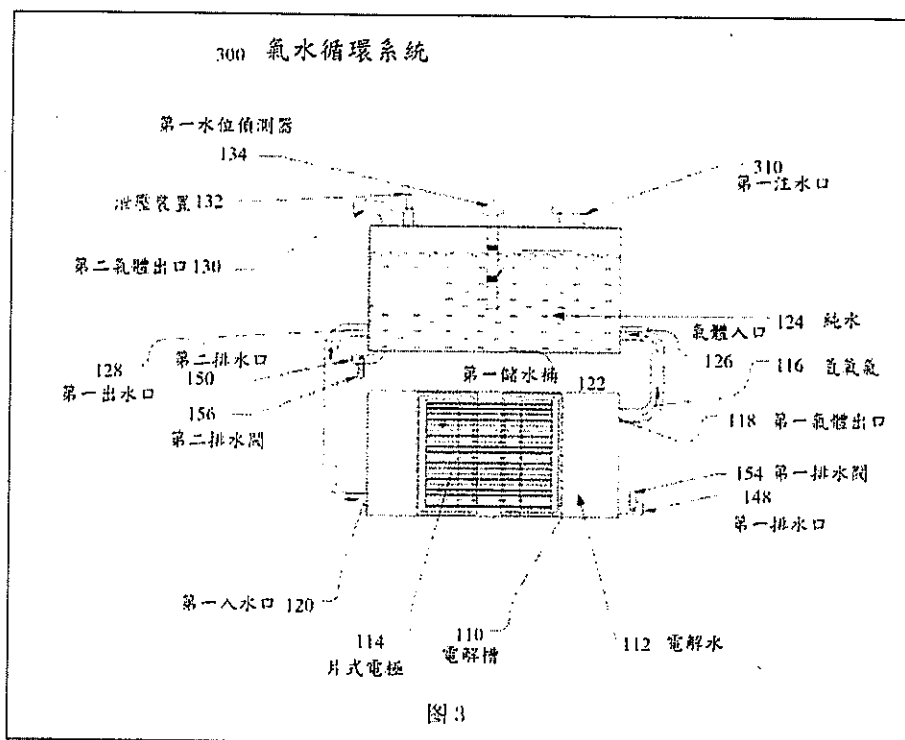


附圖四：

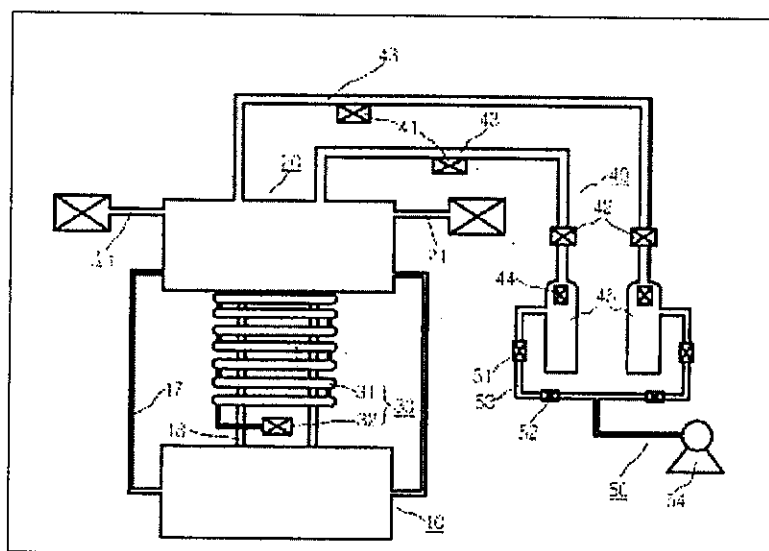


附圖五:

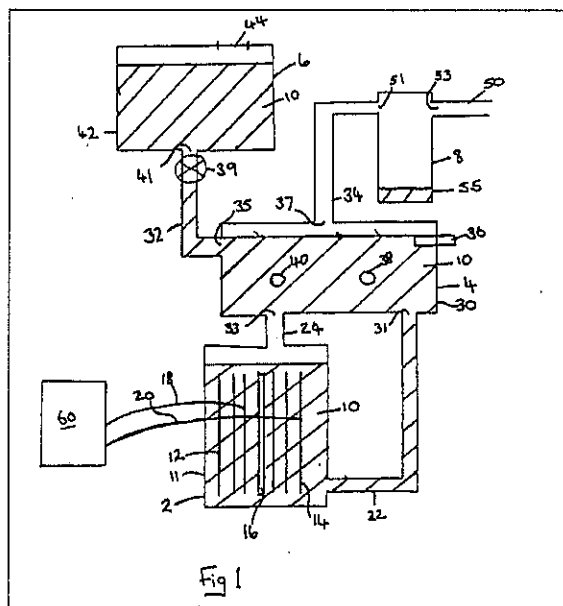

附圖六:

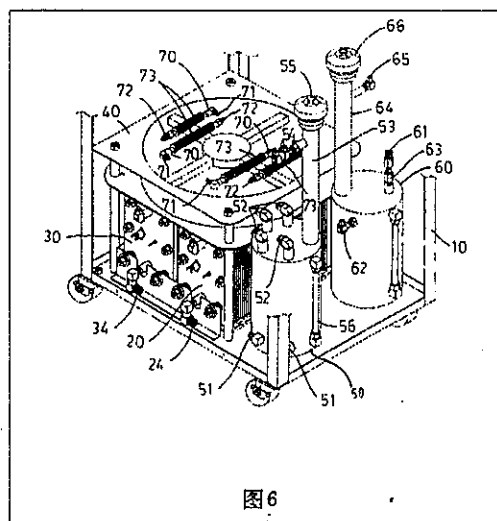

附圖七:

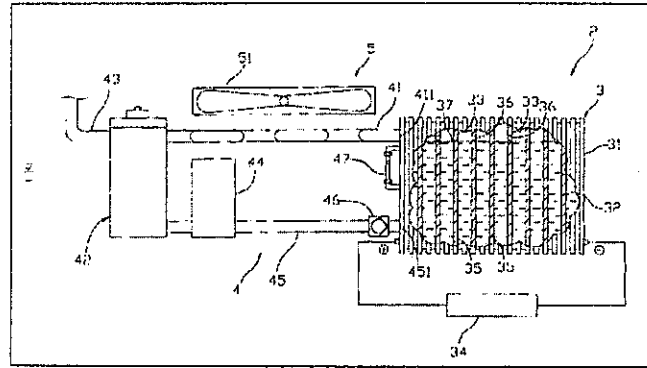

附圖八:

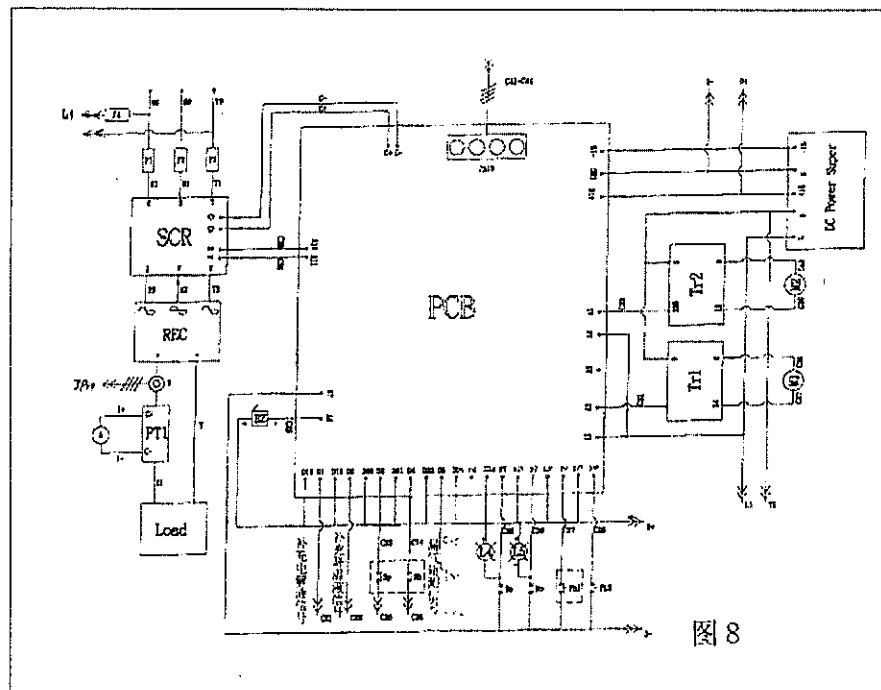


图 8

附圖九:

